

# DuoBravo: Startdisplay

Hauptmenü

Therapeut: MTR

Max 1565  $\mu\text{V}$  Threshold: 89  $\mu\text{V}$  Max

Min 0,7  $\mu\text{V}$

50  $\mu\text{V}$

Min

Max

DuoBravo

Programm: 5

Batterie: Batterie fast voll

Firmware: 30

Patienten Datenbank

Diagnostizieren

Neuer Leistungstest Arbeit/Ruhe

Therapie

Neues Arbeits/Ruhe Training

Neues Gerätegesteuertes Training

Freie Anzeige

Neues Training mit Vorlage


Verschiedenes

Therapeuten verwalten

Diagnosen verwalten

MTR+  
vertriebs gmbh

# DuoBravo: Leistungsdiagnostik (2 Diagramme)/performance diagnostic (2 diagrams)

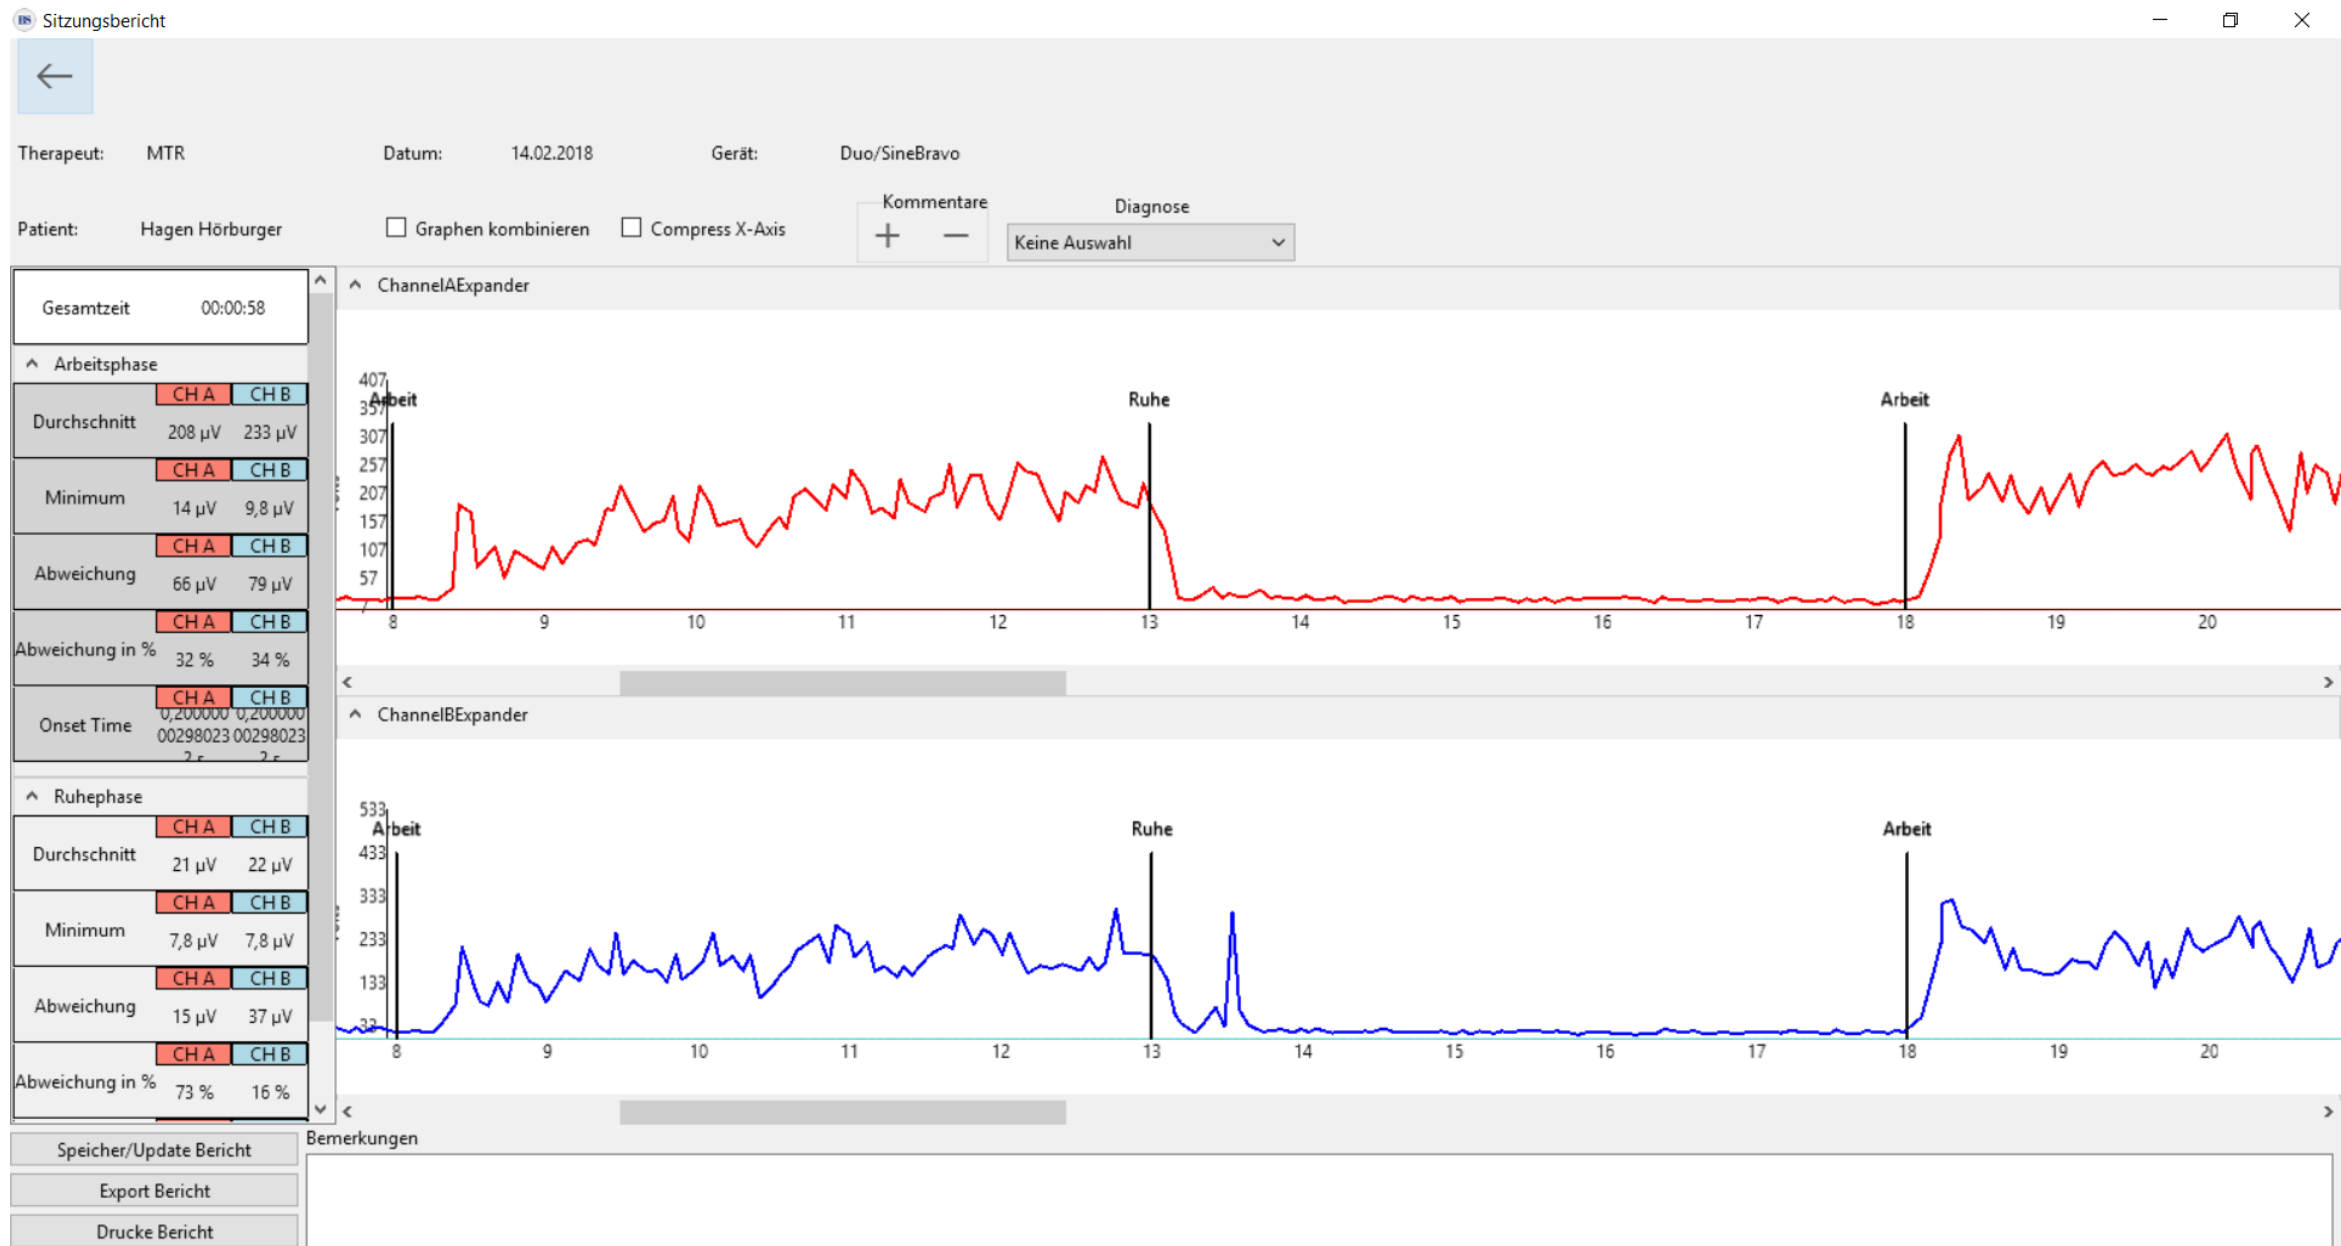


# DuoBravo: Leistungsdiagnostik (2 Diagramme)/performance diagnostic (2 diagrams)

## Druckversion/printversion




# DuoBravo: Leistungsdiagnostik (2 Graphen, 1 Diagramm)/performance diagnostic (2 graphs, 1 diagram)

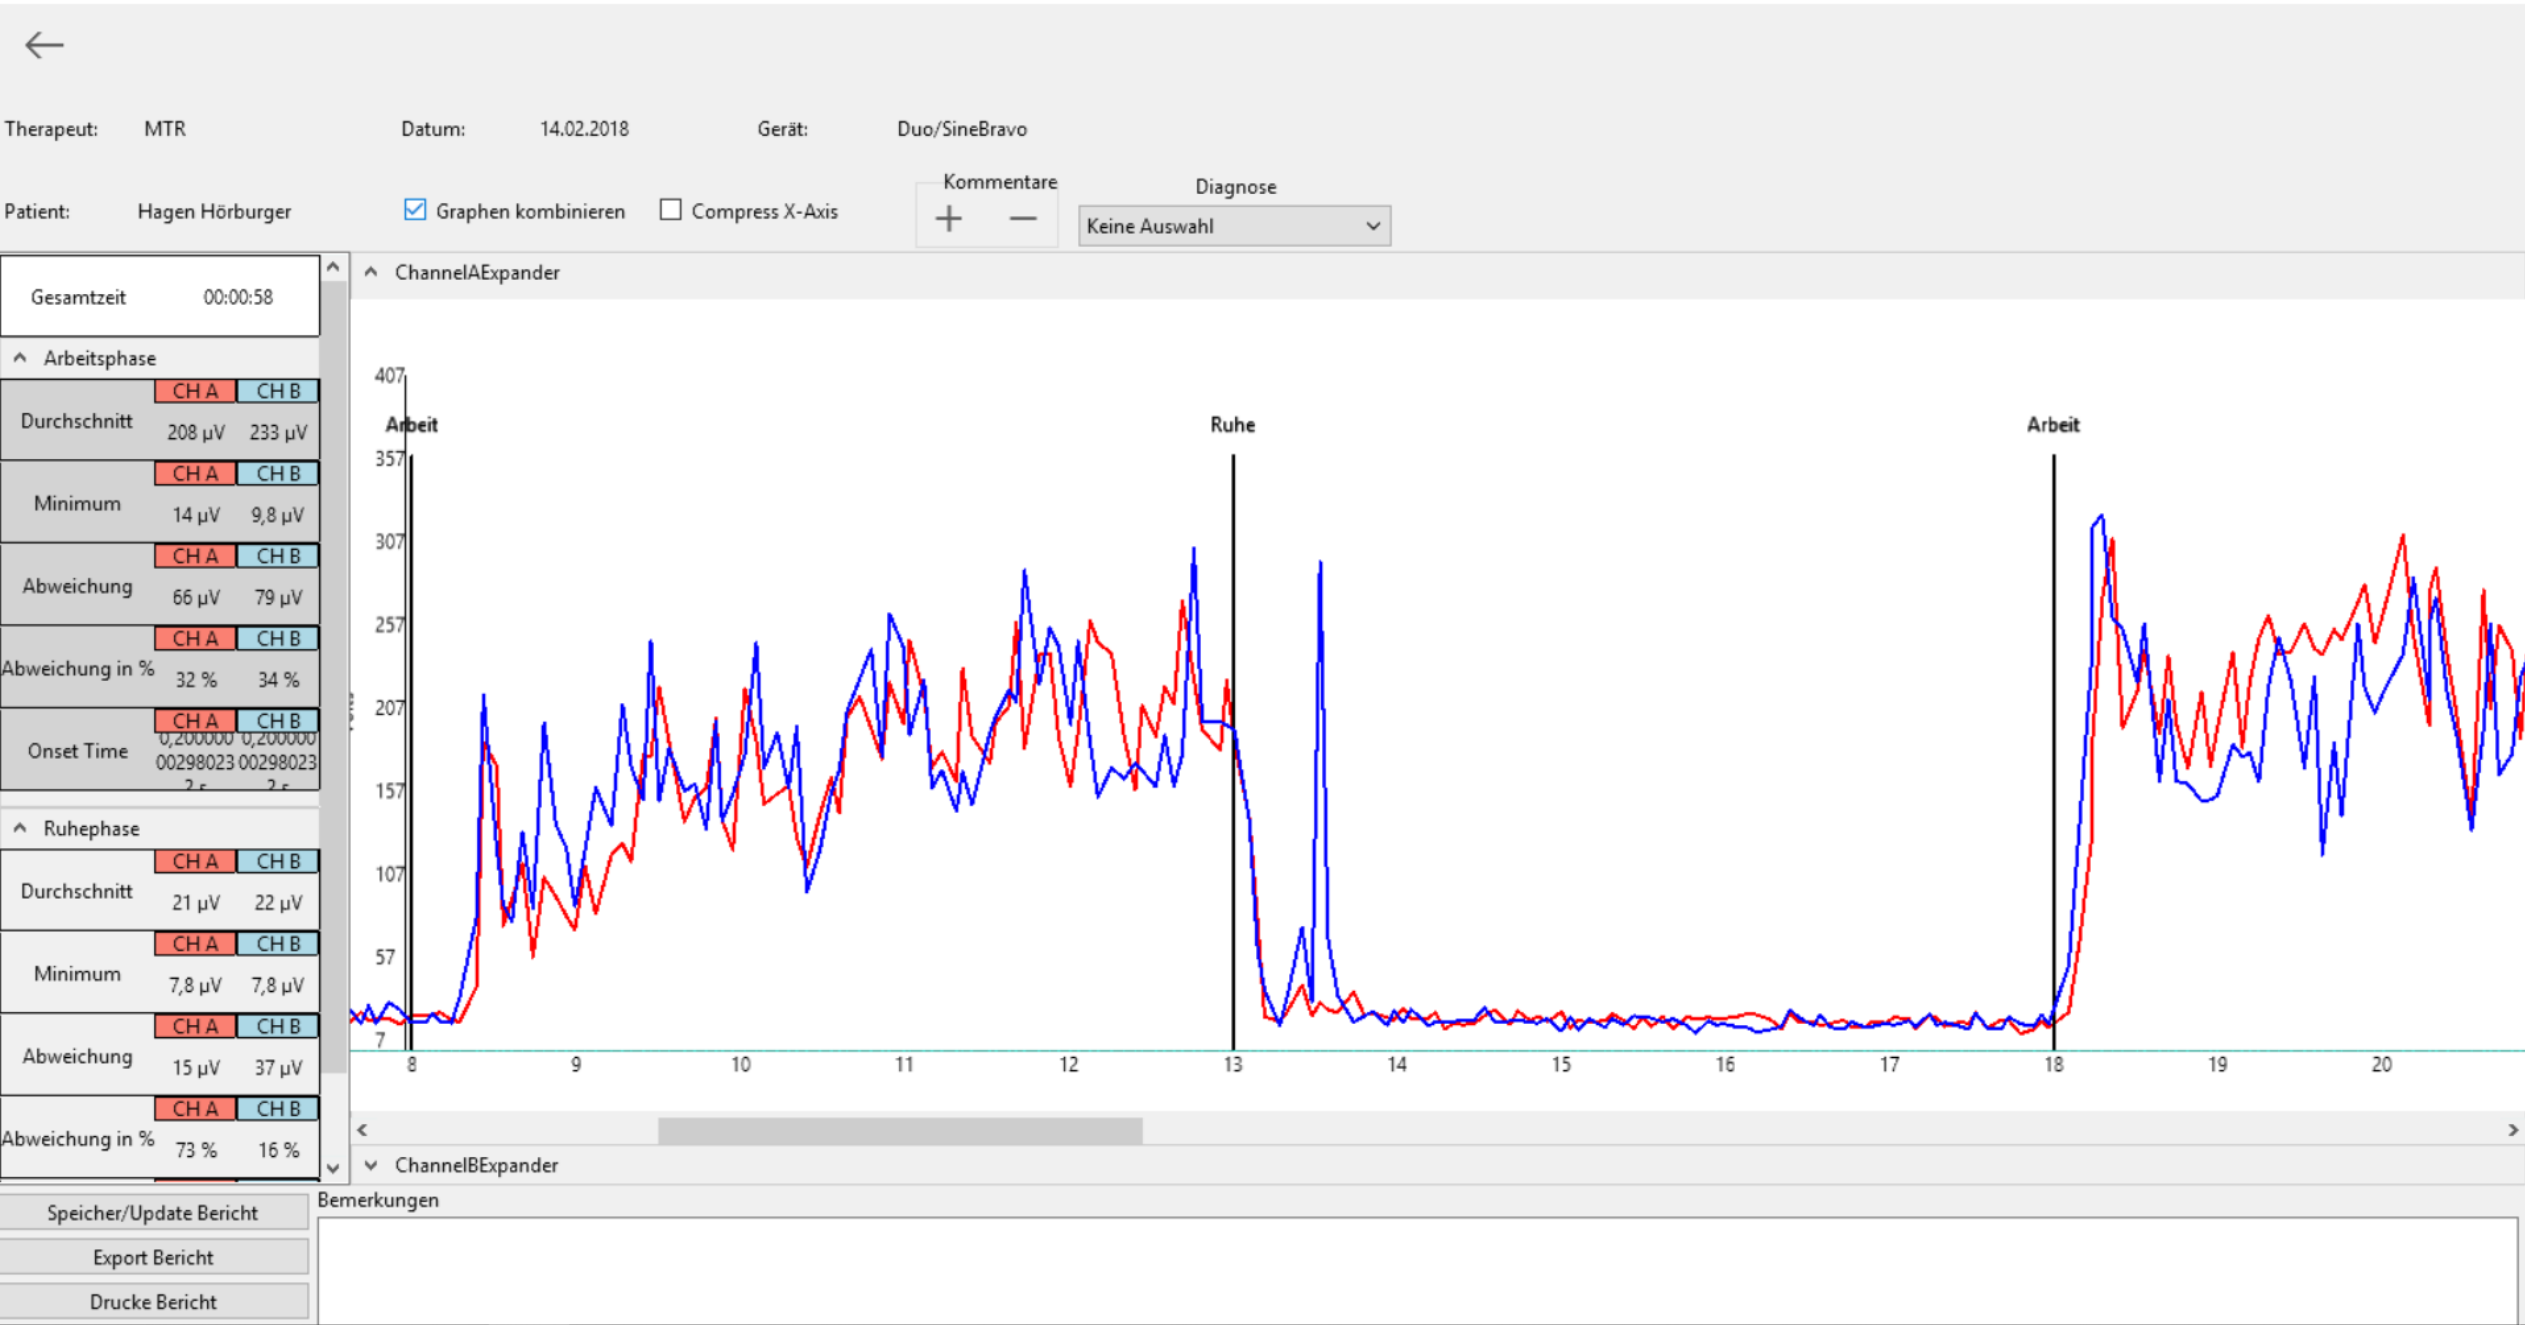


# DuoBravo: Leistungsdiagnostik (2 Diagramme)/performance diagnostic (2 diagrams)

## Druckversion/print version

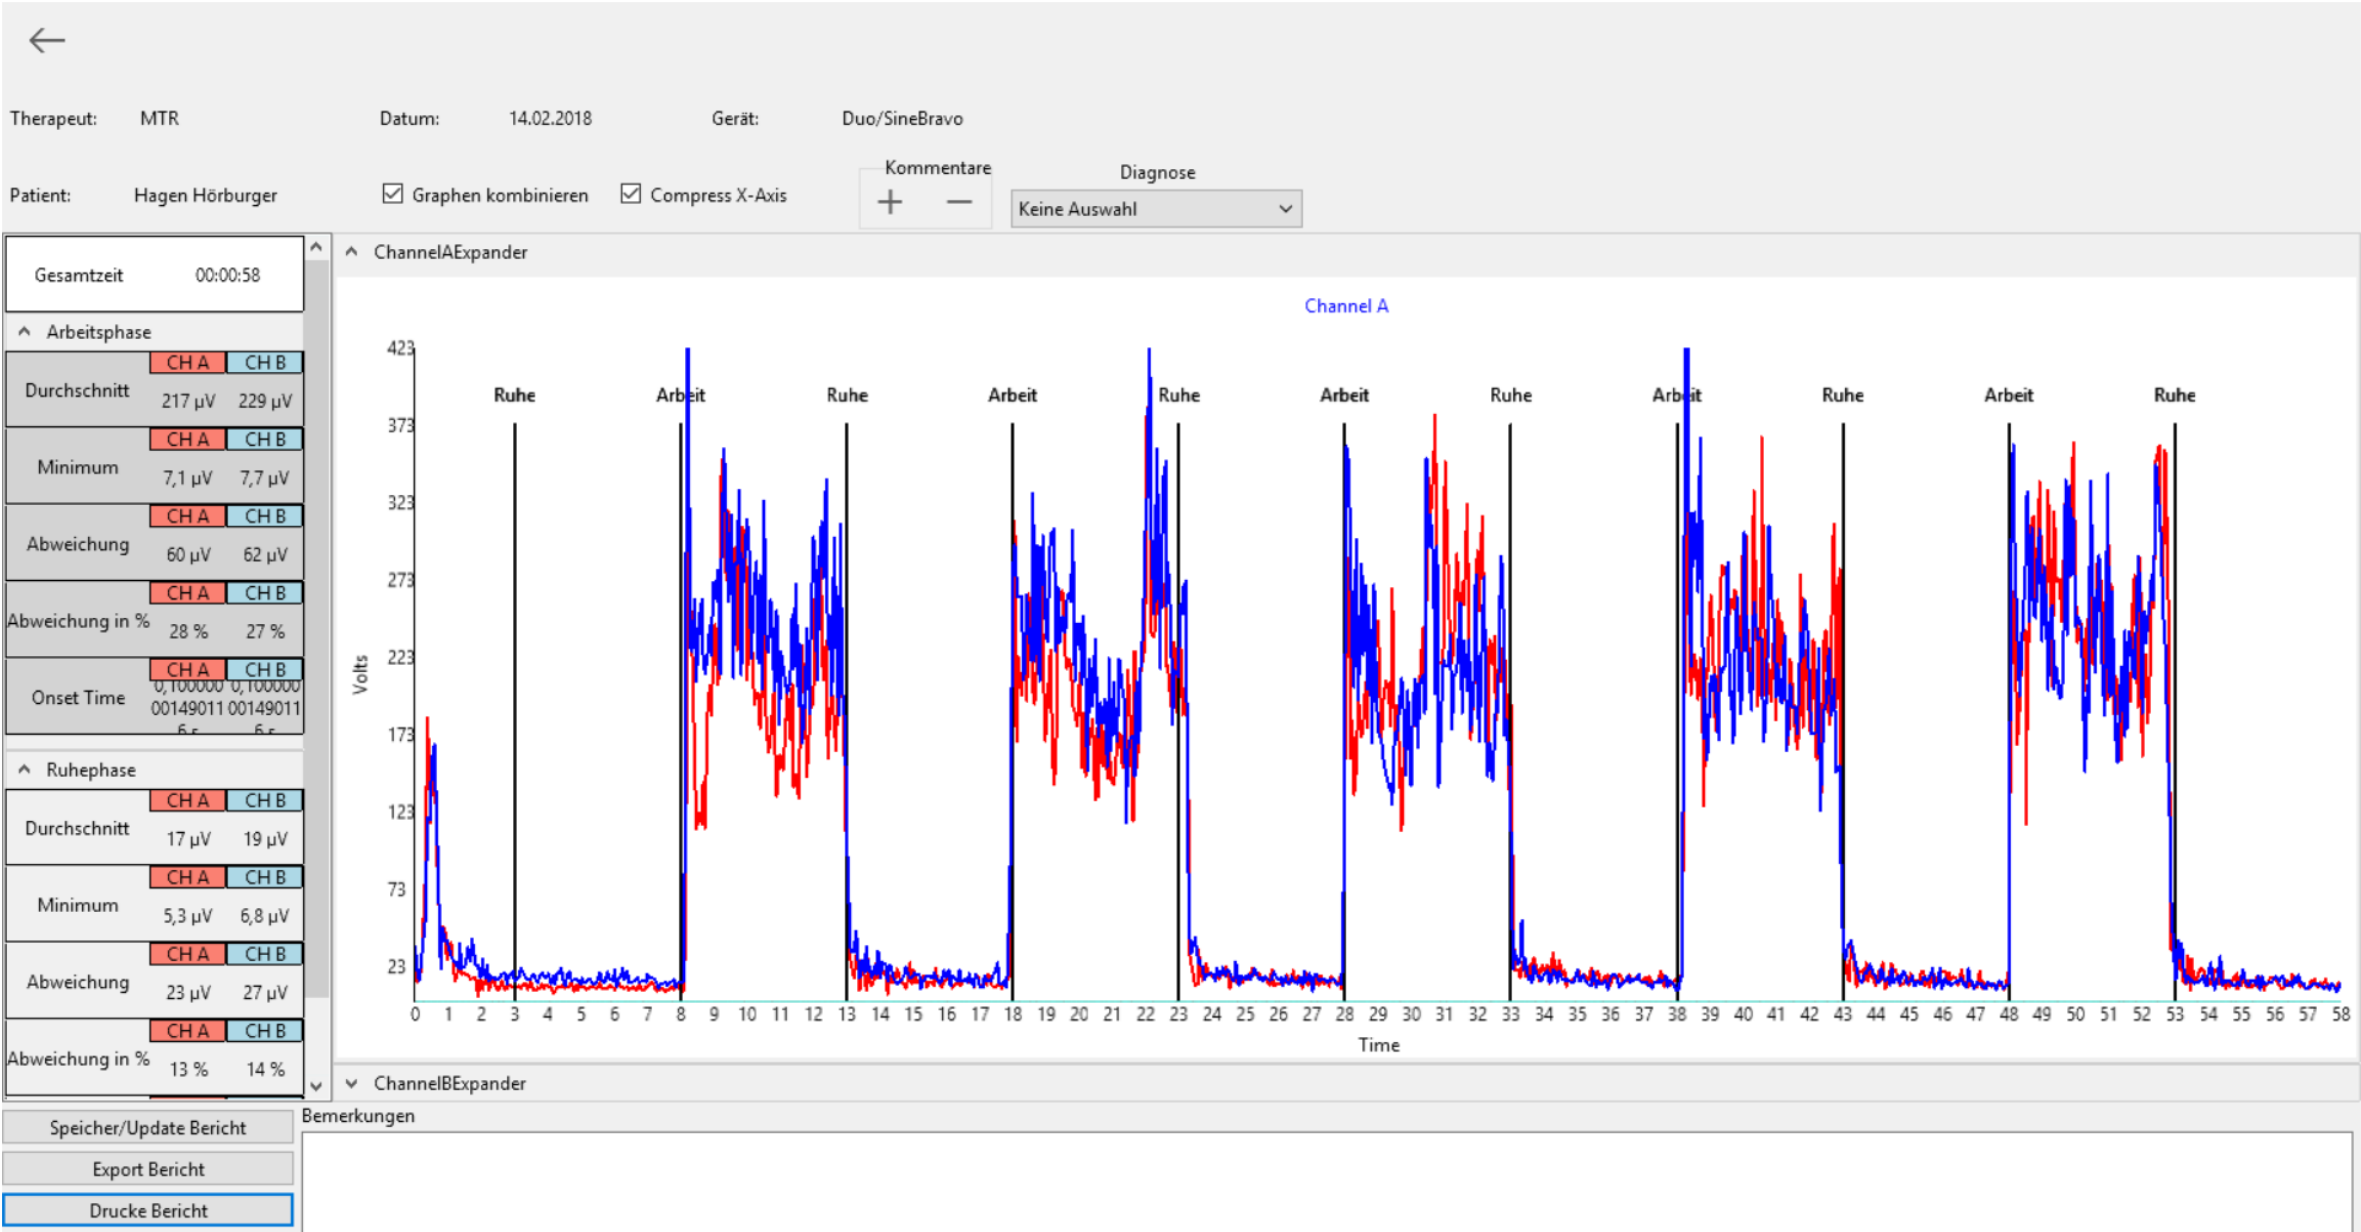

# DuoBravo: Fortschrittsbericht/progress report

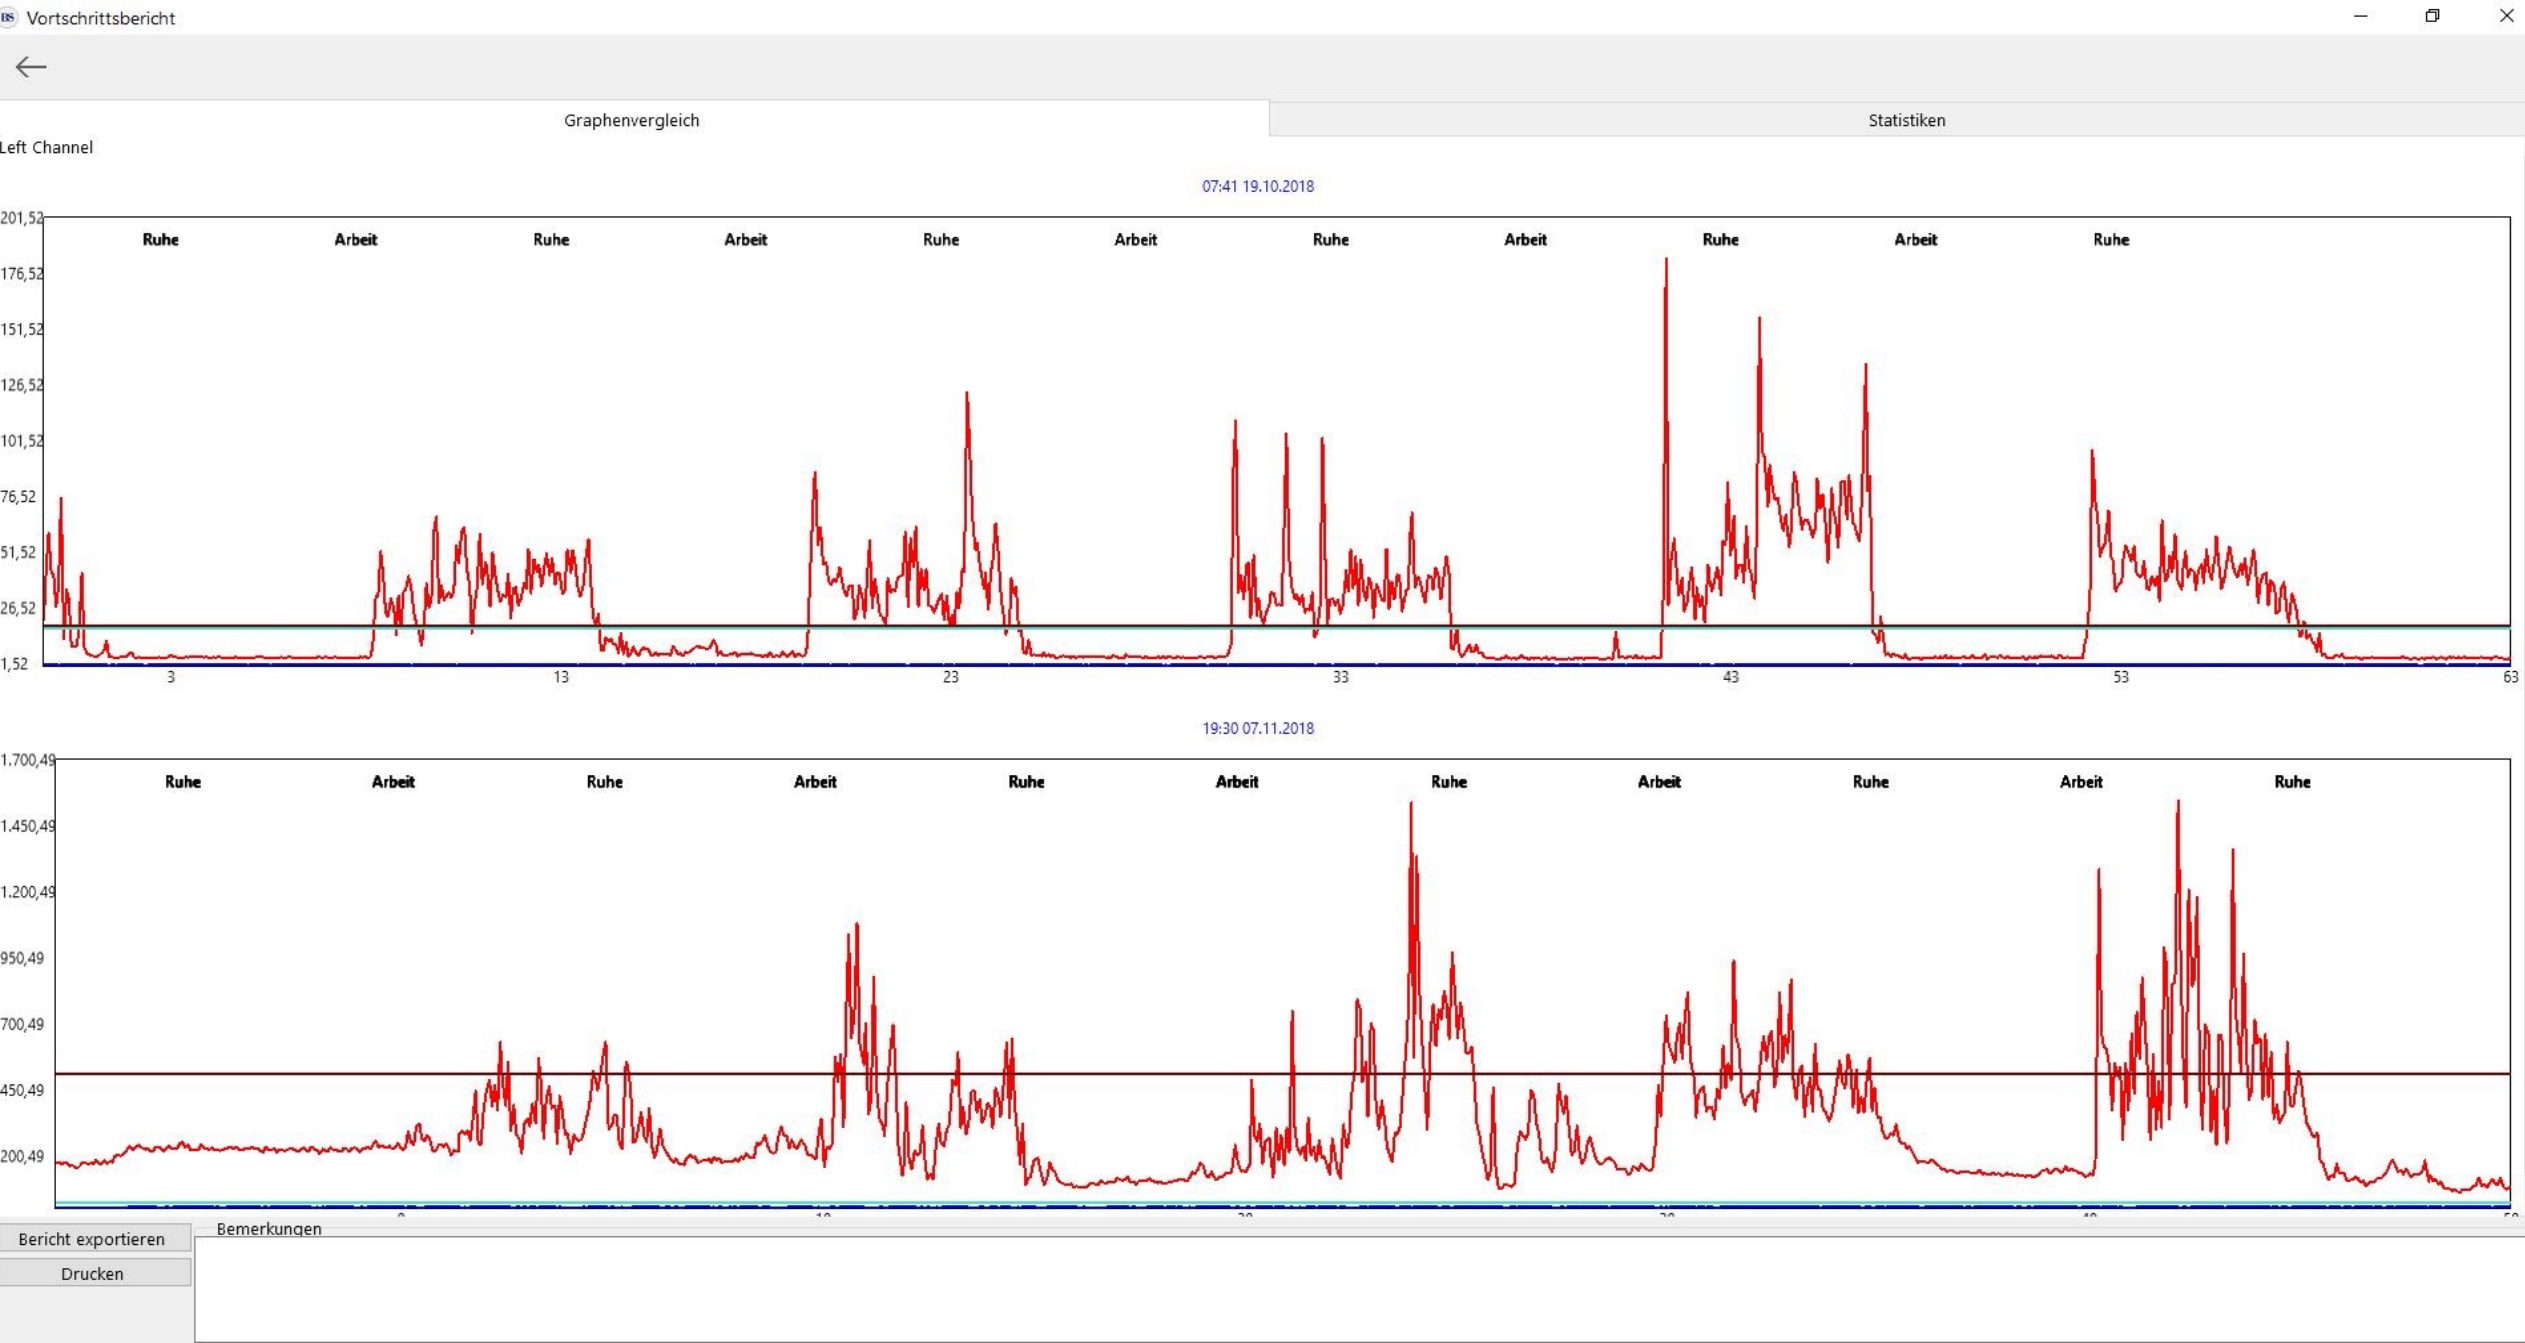





# DuoBravo: Training nach Vorlage/template training

